

DP70簡易取扱説明書(明視野撮影)

【明視野撮影】


- ① DP Managerの起動
- ② DP Contorollerの起動
- ③ プレビューの表示
- ④ 露出モードの設定
オート
- ⑤ 測光範囲の選択
(0.1%・1%・30%)
- ⑥ フレーミング・フォーカシング
オート
- ⑦ 測光範囲の移動
露出補正
- ⑧ ホワイトバランスの調整
- ⑨ 画像取り込み
- ⑩ 画像の保存

マニュアル
オート


マニュアル
オート

⑤' 露出時間の設定


⑦' 露出時間の微調整




① デスクトップ上のアイコンをクリックし DP Managerを起動させる。

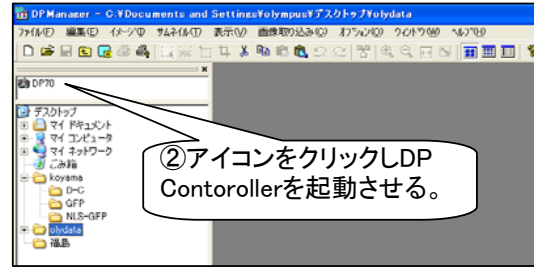

② アイコンをクリックし DP Contorollerを起動させる。

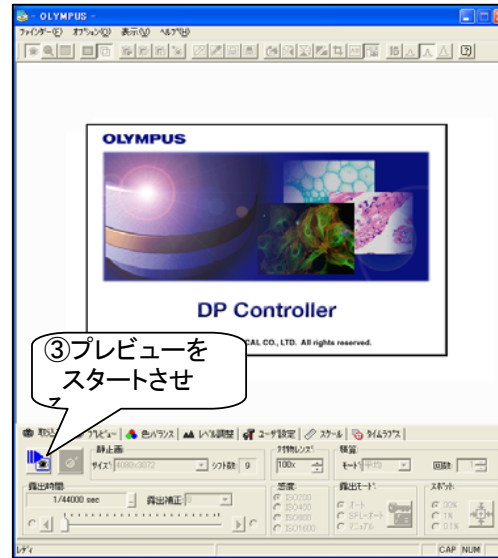

③ プレビューをスタートさせ

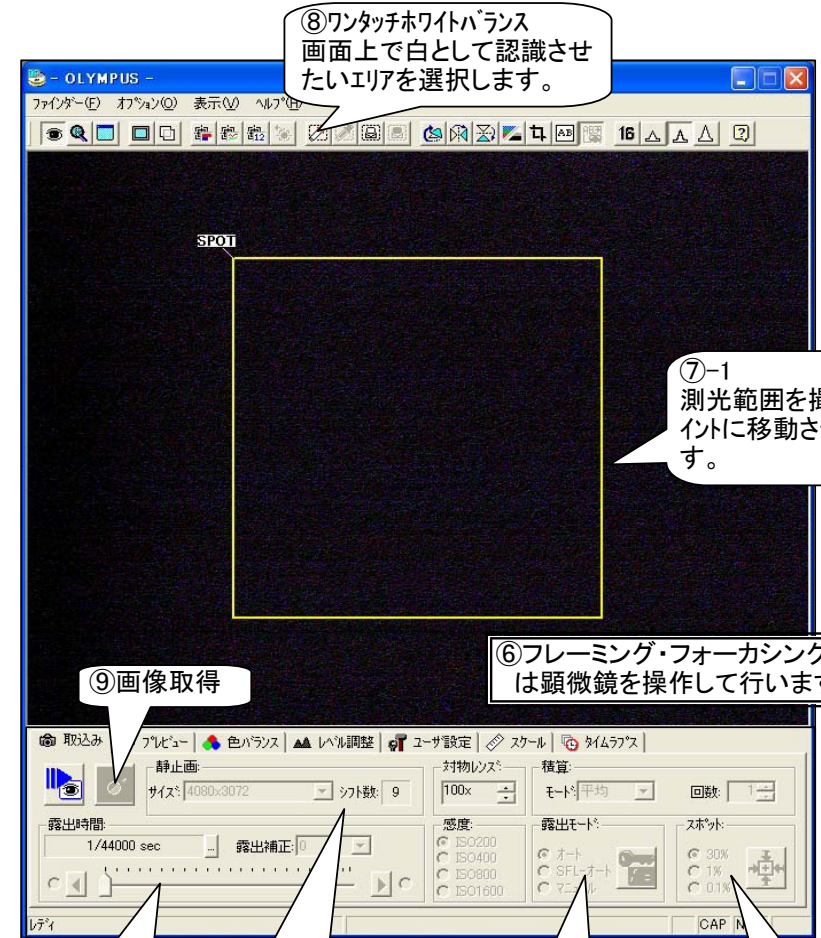

⑧ ファンタッチホワイトバランス画面上で白として認識したいエリアを選択します。

⑦-1 測光範囲を撮影ポイントに移動させます。

⑥ フレーミング・フォーカシングは顕微鏡を操作して行います。

⑨ 画像取得

⑤' ⑦' 露出時間の設定及び微調整を行います。

⑦-2 露出補正を行います。
+: オーバー側に補正
-: アンダー側に補正

④ 露出モードを選びます。オートorマニュアル

⑤ 測光範囲を選択します。

⑩ DP Manager上に取得画面が表示されるので、「ファイル」→「名前をつけて保存」にて保存します。

DP70簡易取扱説明書(蛍光撮影)

【蛍光撮影】




- ① DP Managerの起動
- ② DP Contorollerの起動
- ③ プレビューの表示
- ④ 露出モードの設定
SFLオート
- ⑤ 測光範囲の選択
(0.1%・1%・30%)
- ⑥ フレーミング・フォーカシング
- ⑦ 測光範囲の移動
露出補正
- ⑧ ブラックバランスの調整
- ⑨ 画像取り込み
- ⑩ 画像の保存

マニュアル

⑤' 露出時間の設定

マニュアル

⑦' 露出時間の微調整

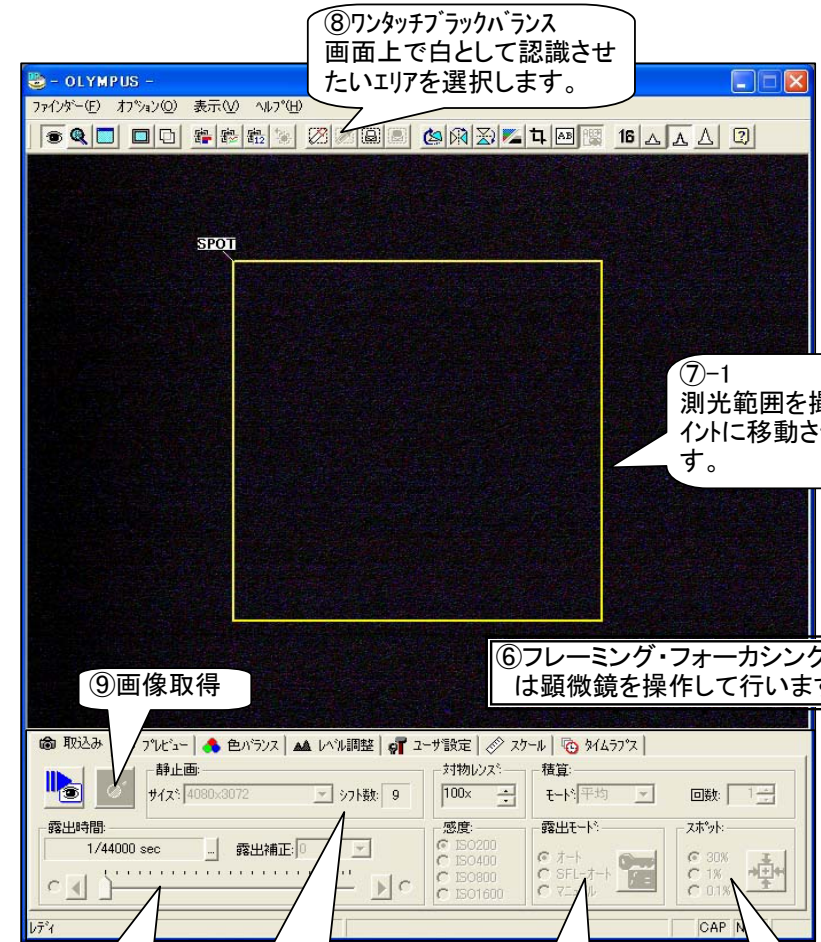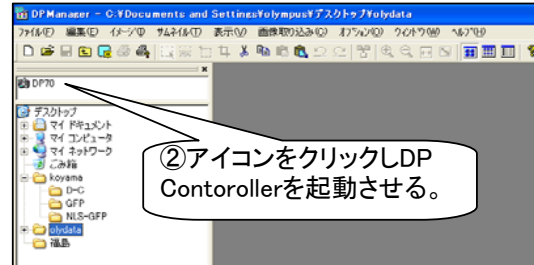

⑤' ⑦' 露出時間の設定及び微調整を行います。

⑦-2 露出補正を行います。
+: オーバー側に補正
-: アンダー側に補正

④ 露出モードを選びます。SFLオートorマニュアル

⑤ 測光範囲を選択します。

⑩ DP Manager上に取得画面が表示されるので、「ファイル」→「名前をつけて保存」にて保存します。

撮影用カメラ簡易取扱説明書 (DP70)

【DP Contoroller 付属機能】

① スケールの表示ができます。


①「スケール」のタブをクリックします。



②スケール表示・非表示等
必要事項をチェックします。


③使用している対物レン
ズ・アダプタを選択します。

※画面を右クリックすると表示色変更設定メニューが表示されます。

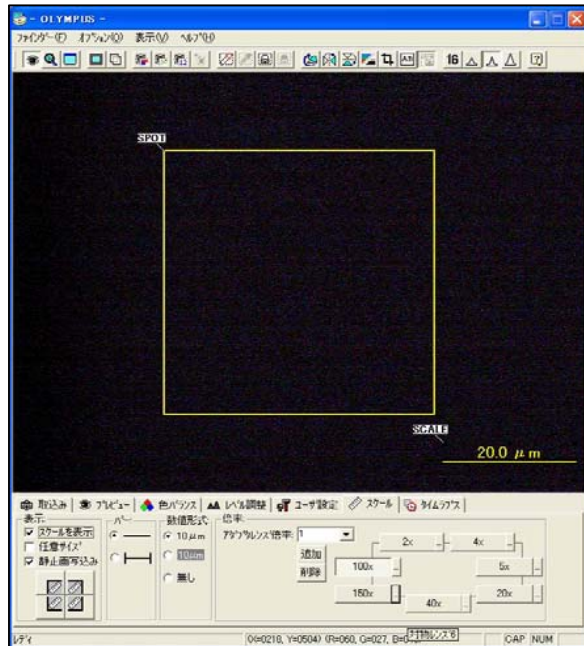

② 撮影条件を保存できます。

①「ユーザ設定」のタブをクリックします。

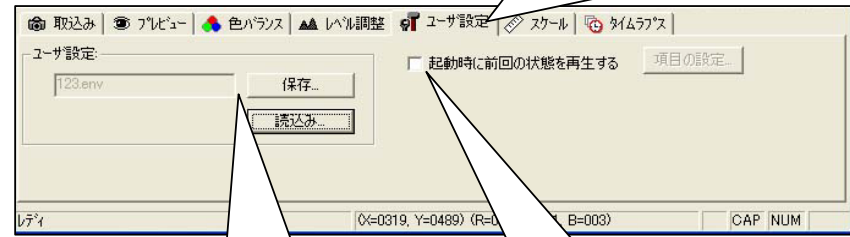

②任意の名称をつけて
撮影条件を保存しま
す。

③前回値の保存の際に
チェックします。

③ 一定間隔撮影(タイムラプス撮影)ができます。

①「タイムラプス」のタブをクリックしま
す。



②チェックを入れ
ます。

③開始時間・間隔・枚数
を設定 します。



④取得後、複数枚数
の撮影画面を連続表
示できるように保存し
たい場合にチェックを入
れます。

撮影画像保存・編集ソフト簡易取扱説明書 (DP-Manager)

【DP Manager 付属機能】

① 取込んだ画像を自動的に指定したフォルダに任意の名称で保存できる機能です。

② 多重染色した蛍光画像の重ね合わせが可能です。

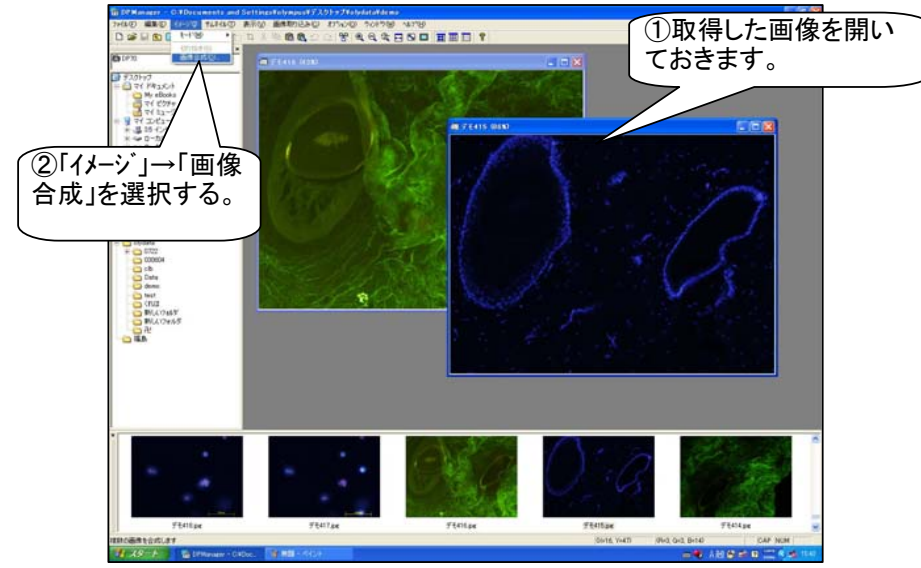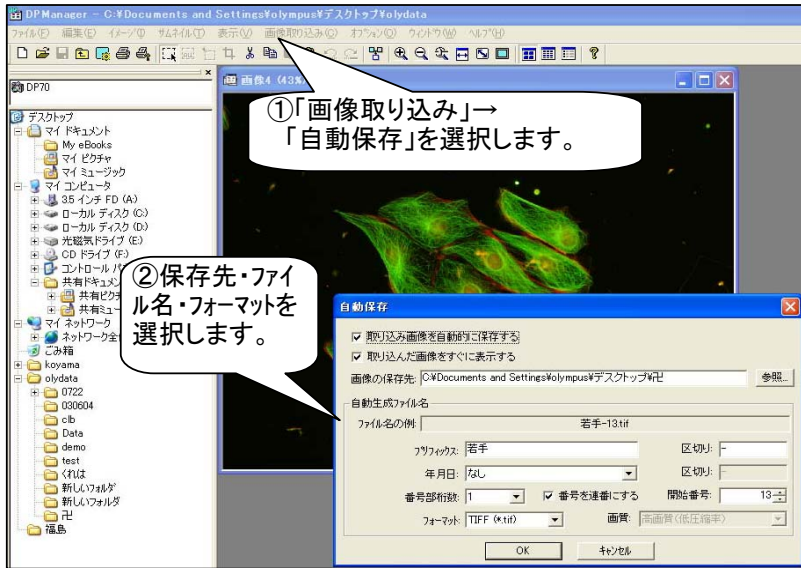

※ ファイル名の設定

